

< KML INFORMATION における訂正とお詫び >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて過日、[KML INFORMATION 2016-08] [KML INFORMATION 2016-09]にて検査内容の変更をご案内いたしましたが、このたび、検査委託先より記載内容を訂正する旨の連絡を受けましたので取り急ぎご案内いたします。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきますので、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

《対象項目/訂正内容》

[ステロイド10分画] [KML INFORMATION 2016-08]

〈正〉

現行の基準値からの変更はございません。
小数第一位でのご報告になります。

〈誤〉


変更内容	新	現
基準値	プレグナントリオロン M : 0.50 mg/day 以下 F : 0.50 mg/day 以下	プレグナントリオロン M : 0.5 mg/day 以下 F : 0.5 mg/day 以下

[カルシトニン] [KML INFORMATION 2016-09]

相関図における単位の訂正 〈正〉 pg/mL 〈誤〉 ng/mL


●カルシトニン (CT) 現法と新法の比較

〈正〉

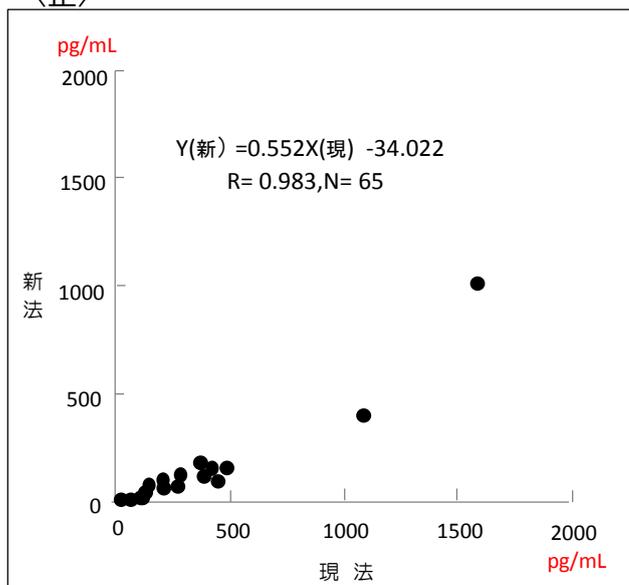

(委託先検討資料)

〈誤〉

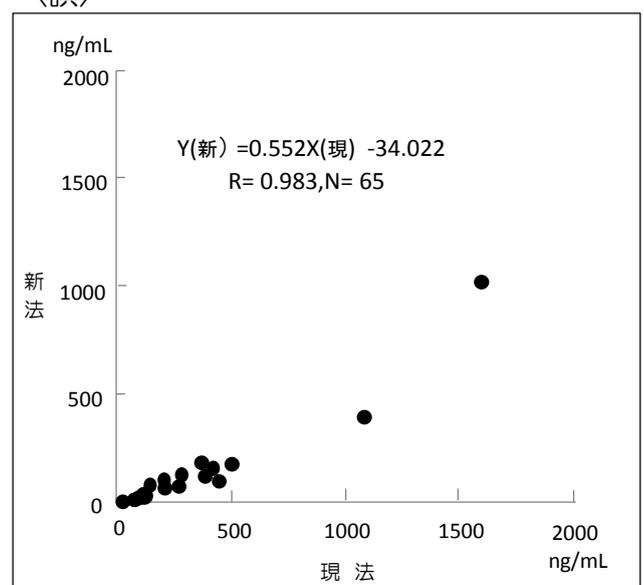

(委託先検討資料)