

< 検査内容変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記項目におきまして、検査内容の一部を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

《実施日》

平成 29年 5月 10日（水）受付分より

項目コード	項目名	変更箇所	新	現	備考	検査案内記載頁
677	プロゲステロン	基準値	下記参照	下記参照	改良試薬への変更	73

※ 現法と新法の比較については裏面をご参照ください。

● プロゲステロン基準値

【新法】

単位：ng/mL


男性		0.2以下	
女性	非妊婦	卵胞期	0.3以下
		排卵期	5.7以下
		黄体期	2.1～24.2
		閉経後	0.3以下
	妊婦	初期 (4週～13週)	13.0～51.8
		中期 (14週～27週)	24.3～82.0
		後期 (28週～38週)	63.5～174.4

【現法】

単位：ng/mL

男性		0.9以下	
女性	非妊婦	卵胞期	0.9以下
		排卵期	2.4以下
		黄体期	1.2～30.0
		閉経後	0.4以下
	妊婦	前期	13.0～50.0
		中期	40.0～130.0
		後期	65.0～220.0

● プロゲステロン 現法と新法の比較

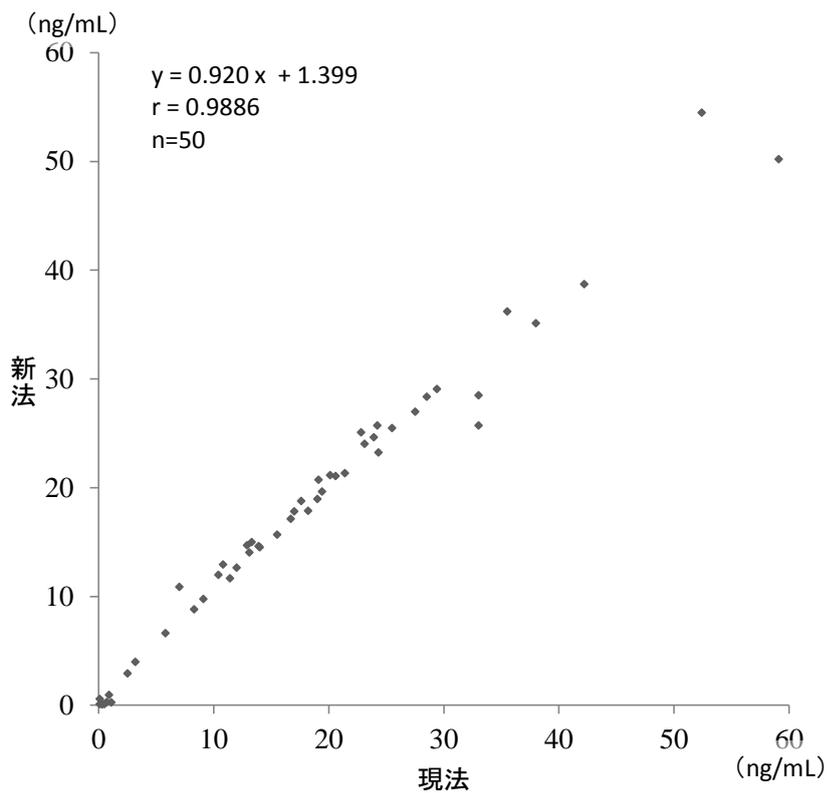

(自社検討資料)